

監控點圖表


監控點: 571-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2023-01-31 08:28 ~ 2023-03-01 08:28

最大值: -80 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -81.0 °C

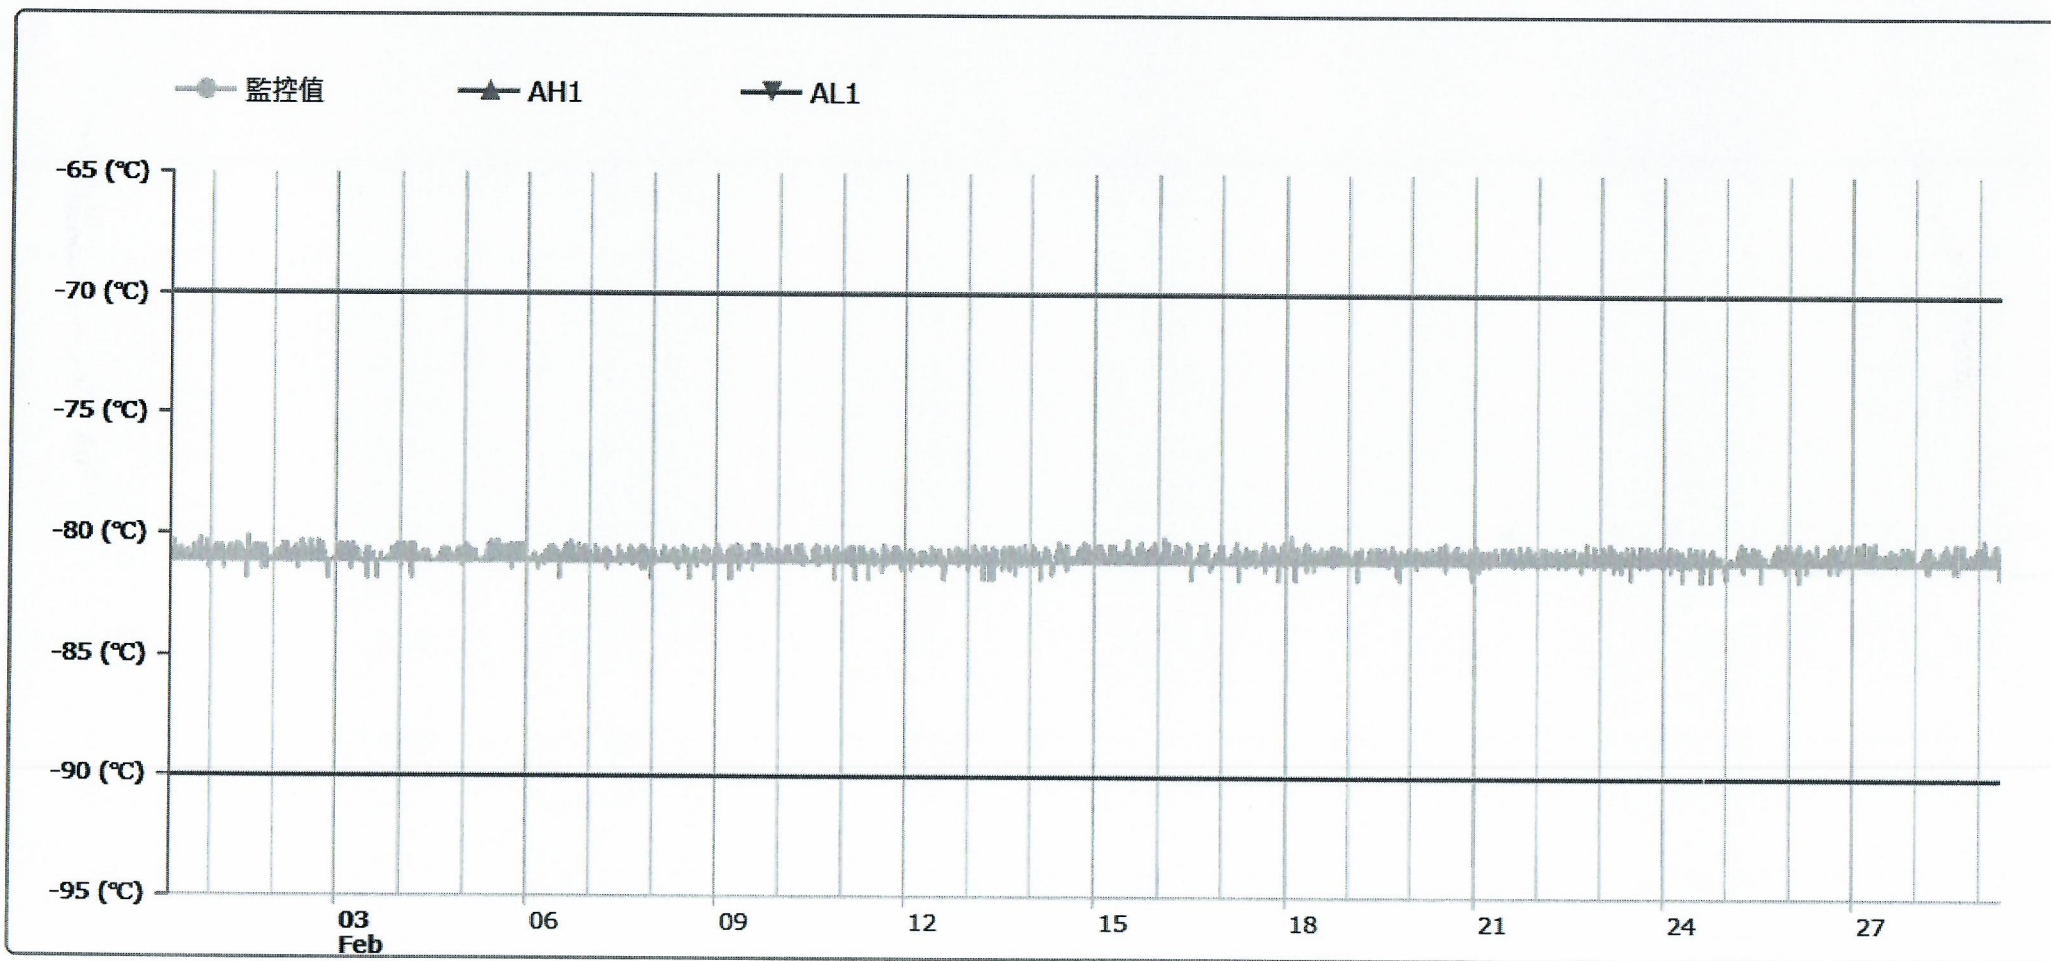

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

Yu Chen
01Mar2023

單位主管:

藥學部 陳秀美
科主任 2023/01/15