

監控點圖表


監控點: 571-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(上)

時間區間: 2023-02-28 08:00 ~ 2023-04-03 08:00

最大值: -77.3 °C

最小值: -81.8 °C

平均值: -81.0 °C

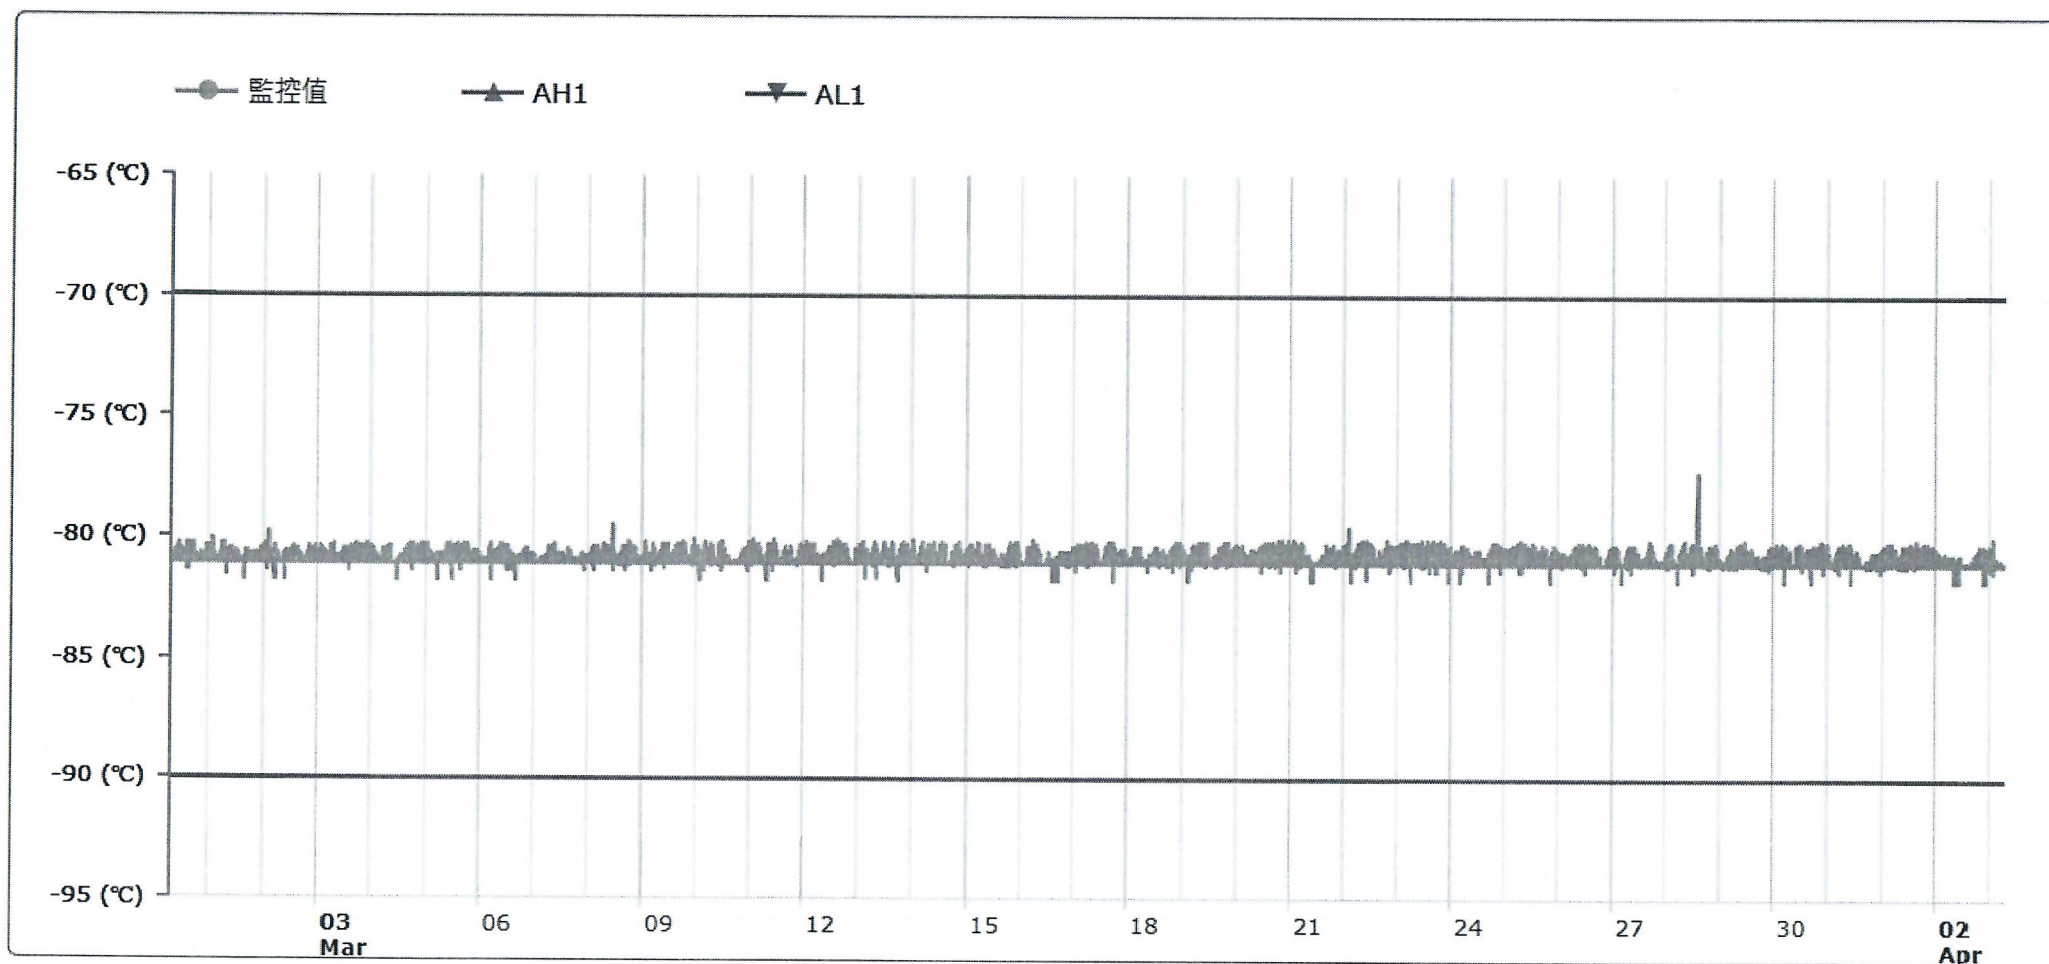

製表者: 臨床試驗藥局-王昱文

Yunwen Wang
03 Apr 2023

單位主管:

藥學部 陳秀美
科主任 1600