

# 監控點圖表


監控點: 572-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(下)

時間區間: 2023-07-31 14:00 ~ 2023-09-01 15:43

最大值: -74.3 °C

最小值: -80.1 °C

平均值: -78.3 °C

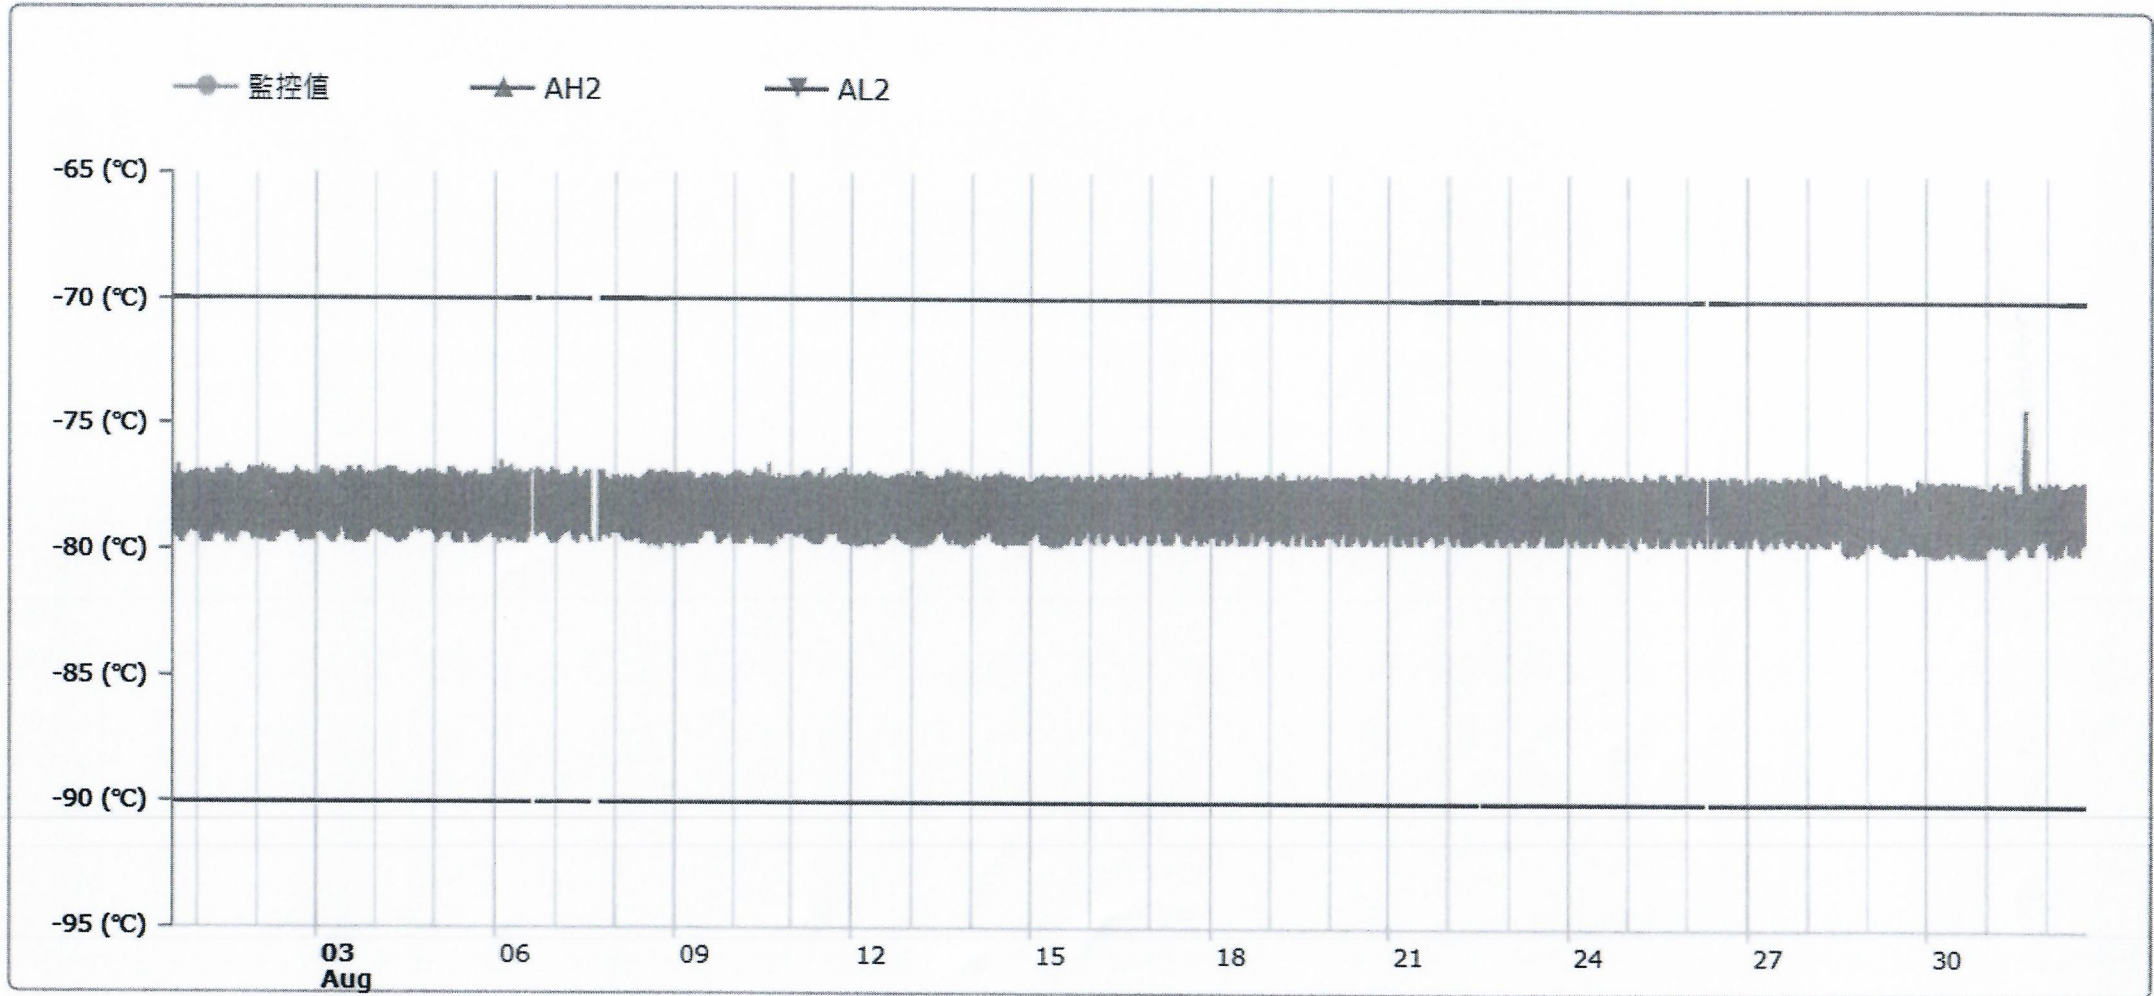

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真

*YumenSu*  
01 Sep 2023

單位主管:

藥學部 陳秀美 29901  
副主任(任編) 650