

監控點圖表


監控點: 572-急診BI-臨床藥局-PHCL-C010-(下)

時間區間: 2023-08-31 12:00 ~ 2023-10-02 12:00

最大值: -74.3 °C

最小值: -80.1 °C

平均值: -78.4 °C

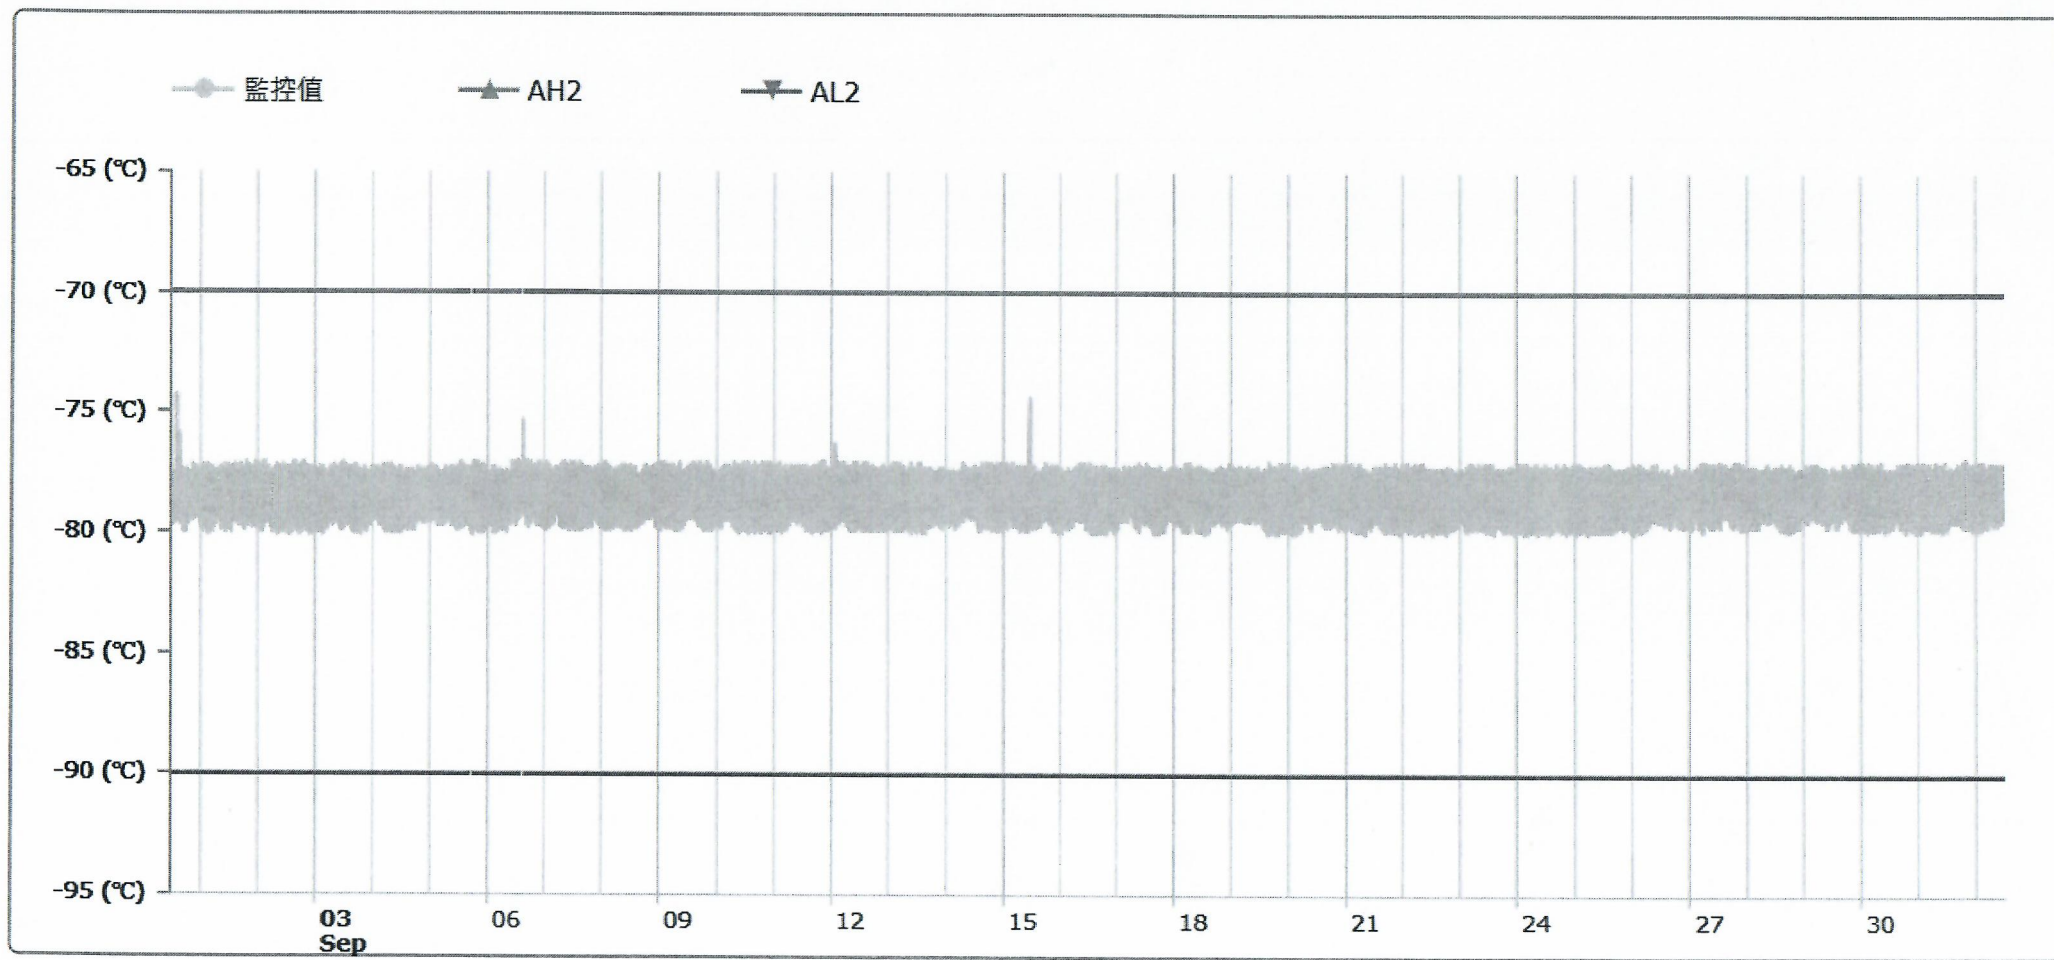

製表者: 臨床試驗藥局-蘇毓真 Yuchewen
02oct>03

單位主管: 藥學部 陳秀美 4006
副主任(任編) 7630